

Rife. Tech?

Vážení čtenáři, žijeme v době, která je přesycena poměrně snadno dohledatelnými a zjistitelnými informacemi, ale stále se najdou lidé, kteří si myslí, že všichni ostatní jsou hlupáci. Přečtěte si, prosím, pozorně tento článek, abyste věděli, co je v roce 2017 možné. Omlouváme se za přílišné rozepisování tohoto „případu“ a také možná za množství technických dat. Vzhledem k prostředí, které zde nyní panuje, berte prosím ale tento článek i jako materiál pro budoucnost. Na náš trh se totiž chystají další „převratné a lepší výrobky“. Podobnost s tím, který budeme popisovat zde? Možná ano, možná ne. Frekvenční terapie jsou totiž zdrojem zisku pro mnoho lidí, kteří svými nezalostmi a prapodivnými „přístroji založenými na biorezonanci“ vnášejí do celé této oblasti zmatky, následně budící nedůvěru jak klientů, tak i odborné veřejnosti. Ne každý přístroj, který svítí a produkuje tzv. „frekvence“, funguje tak, jak je žádoucí, a ne každý výrobce zná principy nezbytné k tomu, aby jeho přístroj plnil daný účel.

text a foto: Pavel Eiselt, Z-Technology s.r.o.

Počátkem léta 2017 se do firmy Z-Technology s.r.o. dostala první informace, že je nějaká brněnská „plazma“ a že nás její výrobci veřejně pomlouvají na svých internetových stránkách. S překvapením jsme zjistili, že je to pravda. Shodou okolností můj dávný kamarád, který tento přístroj právě zakoupil, mi ho na několik dnů zapůjčil. Takže jsme se tedy na převratný přístroj zvaný Sanoplasma podívali podrobněji.

Možná je to osud, možná něco jiného, ale nemyslím, že tento článek bude pro Rifetech s.r.o. (výrobce Sanoplasmy) „hodný zářimování“. Nikdo z naší firmy Z-Technology s.r.o., ani já osobně, v době zveřejnění „Důležitých upozornění“ výše uvedenou firmou, o této firmě a jejím výrobku v podstatě nic nevěděl, přístrojem s názvem SANOPLASMA jsme se nijak podrobně nezabývali. To je minulost. Nyní ho známe dopodrobna a tyto informace si rozhodně nemůžeme nechávat pro sebe. Desítky telefonátů od našich zákazníků a terapeutů, osobní dotazy – proč s tím něco neděláte? ... trpělivé vysvětlování... Pracujeme, i když to na veřejnosti není znát. Jen pro zajímavost... celé pro nás zcela zbytečné měření a zjišťování parametrů přístroje, jakých jsou na světovém trhu desítky a není ničím výjimečný, stálo naši firmu cca 90 000 Kč. Tyto peníze mohly jít do finančně nesmírně náročného výzkumu probíhajícího v současné době na dvou zahraničních pracovištích.

Posuďte sami fakta, která jsme v průběhu dvou měsíců zjistili a která nyní míří k veřejnosti také díky časopisu NR. Tyto informace samozřejmě zveřejníme i na našem webu www.zapper.cz a necháme přeložit do několika jazyků.

Na webové stránce firmy Rifetech s.r.o. – www.rifetechology.cz (držitel domény Martin Rymeš) se na začátku července 2017 objevil velký nápis s tímto zněním:

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Nenechme se zmást lživými výroky nekalé konkurence Z-Technology s.r.o.

Z několika zdrojů se k nám dostala nemilá informace, že konkurenční firma Z-Technology s.r.o. lživě pomlouvá náš přístroj Sanoplasma. Majitel firmy Pavel Eiselt bez jakéhokoliv důkazu označuje Sanoplasma za podvodný přístroj, který vypadá jako „plazma“, ale ve skutečnosti nic nevyzařuje a je nefunkční. Velice rád používá přirovnání, že auto bez motoru vás nikam nedoveze. Zdůrazňujeme, že pan Eiselt NIKDY neměl náš přístroj k dispozici, tudíž jsou veškerá jeho vyjádření o Sanoplasmě zcestná a lživá. Jedná se o nekalou konkurenci a snahu poškodit naši firmu. Považujeme za nezbytné se k těmto pomlůvám vyjádřit nejen

z důvodu ochrany dobrého jména naší společnosti, ale především proto, abychom uvedli na pravou míru dezinformace sloužící k manipulaci laické veřejnosti.

Budeme komentovat jen některá tato slova. Na fotografii níže vidíte, že pan Pavel Eiselt tento přístroj k dispozici měl. Takže již „veškerá“ vyjádření o tomto přístroji „zcestná a lživá“ rozhodně nebudou. O „nekalé konkurenci“ firmy Rifetech bychom mohli hodně diskutovat... Oslovujeme tedy tímto „laickou veřejnost“, jak je uváděno. Posuďte sami, jak a kdo manipuluje veřejností, která věří tomu, co výrobce píše a prohlašuje o svých přístrojích. Kdyby se jednalo o mixér nebo vysavač, tak by to bylo sice na pováženou, ale nikoho by to asi výrazně neohrožovalo. Ale pokud se jedná (jak sama firma Rifetech uvádí ve svých materiálech) o zařízení „sloužící k bezkontaktní likvidaci mikroorganismů“, je to, co jsme zjistili, na pováženou.



Pavel Eiselt s přístrojem Sanoplasma

Nyní další část důležitých upozornění zveřejněných firmou Rifetech.

Pan Eiselt arogantně prezentuje své přístroje jako nejlepší na světě, ale tato samochvála bohužel není ničím podložena. Ale to přece vůbec nevádí. Vždyť bohatě stačí zneužít jistý „časopis“ k propagaci vlastních produktů, neustále opakovat, že naše přístroje jsou prostě nejlepší a všichni ostatní jsou podvodníci, kterým jde jen o peníze. Co je psáno, to je dáno. Trefná slova od firmy, která prodává nejpředraženější plazmový generátor na světě Athon 7. No jistě, vždyť je nejlepší na světě... Vyšší cena neznamená vždy vyšší kvalitu!

Pan Eiselt netvrdí, ani netvrdil, že „ostatní jsou podvodníci“. Pan Eiselt ale zná se svým týmem odborníků (kteří znají detailně dílo Dr. R. R. Rife) poměrně dopodrobna současný světový trh, a to, co se tedy nyní nabízí v téhle oblasti. Pan Eiselt tedy nic „arogantně“ neprezentuje, pouze popisuje faktický stav, který i nyní trvá. Komerční, a tedy sériově vyráběné přístroje nabízené firmou Z-Technology s.r.o. jsou světová špička a tento fakt nezmění výle- vy brněnské firmičky, která navíc, dle zveřejňovaných informací, dané problematice patrně ne zcela rozumí.

Slovním spojením „stačí zneužít jistý „časopis“ je míněna samozřejmě Nová Regena. Tento časopis není zneužíván, ale je naopak jednou z možností, jak mj. varovat veřejnost před praktikami různých firem...

Vyjádření firmy Rifetech k přístroji **Athon 7** je tak legrační, že ukazuje na naprostou neznalost této problematiky. **Athon 7 je PRAVÝ Rife**. Není to přístroj napodobující původní Rifeho přístroje (většinou jen vzhledem a „plazmou“ v trubici). Je to původní Rifeho přístroj. Proto je také jeho cena velice vzdálena tomu, co se nyní celosvětově nabízí. Postavit něco takového totiž není vůbec jednoduché. Pojdme ale dále:

Vývoji naší Sanoplasmy předcházela několikaletá práce s mnoha konkurenčními přístroji zahraniční výroby. V průběhu pěti let nám prošlo pod rukama několik tisíc klientů (netuším, kolik let praxe měl pan Eiselt, než vyrobil „zázračné“ RPZ 14). Nejlepší výsledky jsme měli s přístrojem TrueRife z USA, který je na trhu mnohem déle než RPZ 14 a je ve světě mnohem známější. Při určování charakteristik Sanoplasmy jsme se inspirovali právě tímto přístrojem. Naším cílem bylo dosáhnout srovnatelných hodnot účinného elektrického pole, což se nám podařilo. Sanoplasma ve skutečnosti TrueRife převyšuje ve frekvenčním rozsahu téměř 100x!!! Při sestavování Sanoplasmy jsme také mysleli na potenciálně nebezpečné vyšší harmonické frekvence, které mohou zasahovat až do pásma tzv. vysokofrekvenčního záření. Naše Sanoplasma obsahuje speciální filtry, které tento „elektrosmog“ eliminují na minimum.

Ano, několikaletá práce dokonce s našimi přístroji. Rodina Rymešova, která stojí za vznikem rodinné firmy Rifetech s.r.o. s námi opravdu dlouho a poměrně úspěšně spolupracovala.

Firma Rifetech netuší, kolik let praxe měl pan Eiselt, než vyrobil „zázračné“ RPZ 14. Pan Eiselt nebyl, není a nebude terapeut ani jakýkoliv poradce. Přesto v tomto oboru pracoval dlouho před „terapeutickou“ praxí rodiny Rymešovy a mnoho let před vznikem „firmy“ Rifetech.

Pan Eiselt ani nikdo z firmy Z-Technology s.r.o. netvrdí, ani netvrdil, že je RPZ 14 zázračné.

Nejlepší výsledky jsme měli s přístrojem TrueRife z USA, který je na trhu mnohem déle než RPZ 14 a je ve světě mnohem známější.

Jaké zkušenosti, to už ale autor tohoto textu neuvádí. Je to zcela účelové tvrzení, které není zcela ničím podloženo a přístroje „TrueRife“ v ČR zná snad jen tato rodinná firma. S firmou TrueRife jsme navázali kontakt několik let před uvedením RPZ 14 na trh, kupovali jsme tam i první trubici pro naše pokusy. Jejich přístroje nás ale ničím výjimečným nezaujaly. Takových přístrojů je po světě mnoho.

Slova: „**Naším cílem bylo dosáhnout srovnatelných hodnot účinného elektrického pole, což se nám podařilo,**“ jsou velmi vtípná. Elektrické pole a jeho „síla“ bude probrána detailněji dále v textu. Toto je asi nejvíce matoucí tvrzení, které firma Rifetech s.r.o. uvádí, a to buď z naprosté neznalosti problematiky, anebo z předpokládané naivity a neznalosti potenciálních zákazníků. Možná ale také zcela cíleně. Každopádně se jí mást své klienty a zákazníky dařilo a asi i daří, a nebyť jejich „smělých“ prohlášení směřovaných k firmě Z-Technology a mé osobě, asi by na to nikdo nepřišel. Čtenáři, znáš to pořekadlo o jámě a tom, kdo jí jinému kopá?

Při sestavování Sanoplasmy jsme také mysleli na potenciálně nebezpečné vyšší harmonické frekvence, které mohou zasahovat až do pásma tzv. vysokofrekvenčního záření. Naše Sanoplasma obsahuje speciální filtry, které tento „elektrosmog“ eliminují na minimum...

Vyšší harmonické frekvence **byly** u přístroje Sanoplasma naměřeny. Při nastavení „**funkčního generátoru**“ (jak firma Rifetech honosně nazývá laciný čínský generátor frekvencí Spooky/Duch/ za 115 USD/cca 2 600 Kč) na 800 kHz připojený k Sanoplasmě, jsme naměřili násobky těchto frekvencí (harmonické) na 1,6 MHz, na 2,4 MHz a 3,2 MHz, dále jsme neměřili.

Otiskujeme zde i další informace, které se nacházejí (10. 11. 2017) na veřejně dostupných prezentacích této firmy. Stojí totiž za to, abyste o nich měli přehled:

Nový plazmový generátor 2 v 1

Jedná se o efektivní metodu bezkontaktní likvidace patogenních mikroorganismů (bakterie, viry, plísňe, paraziti) přenosem přesných frekvencí, kterou R. R. Rife vyvinul již ve 30. letech 20. století. Součástí Sanoplasmy je biofeedback sloužící k detekci přesných rezonančních frekvencí.

Vysoká intenzita účinného elektrického pole

Po zjištění přesných frekvencí patogenních mikroorganismů následuje jejich cílená likvidace Sanoplasmou. Každý mikroorganismus je charakterizován určitou frekvencí. Pokud tuto frekvenci vyšleme, vyvoláme rezonanci a následnou destrukci patogenů.

Přístroj Sanoplasma v sobě integruje frekvenční skener, pomocí kterého naměříte účinné rezonanční frekvence, a plazmový generátor určený k následně bezkontaktní likvidaci patogenů (bakterie, viry, plísňe, paraziti).

Směle si dovolujeme tvrdit, že v současnosti Sanoplasma patří k nejlepším přístrojům svého druhu.

Intenzita elektrického pole 1000 V/m

Vysoká intenzita elektrického pole zajišťuje efektivitu.


Nejsilnější, a tedy i nejúčinnější elektrické pole v porovnání s několika konkurenčními přístroji. Výrobce tvrdící, že přístroj účinkuje do vzdálenosti 10 a více m, mystifikuje. Je třeba rozlišovat dosah a účinnost. Intenzita účinného elektrického pole vzdáleností od přístroje rapidně klesá!

2v1 – kombinace plazmového generátoru a skeneru za bezkonkurenčně nízkou cenu.

Upozorňujeme, že všechny plazmové generátory fungující na nosné frekvenci vyšší než 1 MHz mohou být podle Dr. Huldy Clarkové potenciálně nebezpečné. Tyto frekvence totiž (podle jejího zjištění) zasahují do frekvenčního pásma lidských buněk.

Krátce jen k některým těmto perlám. Sanoplasma tzv. „2 v 1“ za cenu 107 000 Kč se skládá z:

- čínského generátoru frekvencí Spooky (u výrobce za 115 USD)

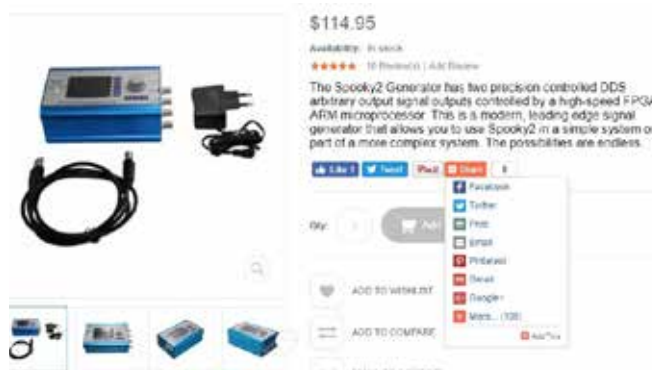

- čínského pulsního klipu na prst s elektronikou, nazývaný zde honosně „Biofeedback“ (u výrobce za 58 USD)



(tohle vše můžete sami zakoupit na čínském webu www.spooky2.com a mají tam dokonce ke koupi i „plazmy“)

- zesilovače(!) Sanoplasma – vyráběného pravděpodobně v ČR



- trubice s neonem a propojovacích kabelů

Tedy ono „unikátní“ 2 v 1 je zesilovač Sanoplasma (zesilovač, který převádí vstupní frekvenci z čínského generátoru na vysoké napětí) s trubicí plněnou neonem a čínský generátor frekvencí s čínským snímačem srdečního tepu. Fakta, nic víc. Trefný postřeh jednoho našeho zahraničního spolupracovníka: Dělat „diagnostiku“ bakterií, parazitů či plísní v organismu na základě srdečního tepu může snad jen čínský výrobce nebo člověk zcela neznalý problematiky reakcí mikroorganismů v tkáních na působení EM pole...

Intenzita elektrického pole, měřená navíc přímo u plazmové trubice, neříká o účinnosti takového přístroje vůbec nic. Pokud budete číst dále, můžete sami posoudit, jak výjimečně „silné“ el. pole (výrobce uváděných 1 000 V/m) Sanoplasma má.

Lidské buňky jsou až v pásmu terahertz (1 THz = 10^{12} Hz)... ve vsí účtě k Hulbě Clarkové – zde se velmi mýlila. Žádné MHz frekvence, jak upozorňují „odborníci“ z Rifetech, tedy potencionálně nebezpečné nejsou. Současné rozdělení frekvenčního pásma pro lidskou činnost působí v pásmech kHz až GHz. EM pole působící na živou tkáň ale musí dosahovat určitého specifického výkonu a expoziční dávky, aby se dosahovalo požadovaných efektů popisovaných dr. Rifem a Huldou Clarkovou.

Zde jsou poznatky z našich měření přístroje Sanoplasma, která probíhala ve dvou na sobě nezávislých pracovištích a v jedné státní zkušební laboratoři.

V Sanoplasmě není **žádná nosná frekvence**. Je to pouhý zesilovač, který zesílí kladné obdélníkové signály do trubice od 1 kHz

do 900 kHz. V nejvyšších pásmech ale signál značně oslabuje parazitní kapacitance.

Výstupní signál je čistý, 50% poměr střídavy mezi 1 a 0 o konstantním relativně malém výkonu v řádu cca 20 W.

RPZ 14 funguje na zcela jiném principu, a to na krátkých impulzech, ve kterých pulzní výkon dosahuje několika tisíců wattů, cca 7 kW. (Podobný princip funguje u meteoradarů, ale ty jsou ještě silnější.) Vzhledem k velmi krátkým impulzům je u RPZ 14 problém s měřením elektrického pole na dálku, protože běžné měřicí přístroje měří efektivní neboli průměrný výkon, nejlépe měřitelný u 50% střídavy, ale s krátkými pulzy to nedokážou. (Tohle je velmi důležité! Jak vidíte, není plazma jako „plazma“, i když se hořně plynů ve výbojce na pohled zdá stejně nebo podobné. Pulzy, které produkují jednotlivé „plazmové“ přístroje, se velmi výrazně liší, což laik – klient – opravdu nepozná, a mnoho výrobců toho zneužívá a mnozí „výrobci“ o tom vůbec nevědí... ☺)

Prezentovaný „detektor“ frekvencí je obyčejný snímač rychlosti tepu srdce, zde jako externí samostatné zařízení spojené s počítačem vyhodnocujícím odchylky v rychlosti tepu, které údajně mají být způsobeny zásahem do frekvence nějakého patogenu. Systémová smyčka tedy reaguje na zpoždění nebo zrychlení následujícího stahu srdce, program si zapamatuje, jaká byla frekvence, když se projeví změna rytmu nad určitou nastavitelnou hranici.


Sestava je **potenciálně** nebezpečná. Pokud totiž měří „biofeedback“ snímačem rychlosti srdečního tepu umístěným na prst člověka elektricky vodivým propojením s PC napojeným na Sanoplasmu, v případě možného proražení optočlenů pravděpodobně dojde u snímaného člověka k zásahu vysokým napětím přes USB v PC. Předpokládáme, že na čínský snímač srdečního rytmu a generátor Spooky také existují české bezpečnostní certifikáty, jinak tu hrozí velký průšvih ze strany státního dozoru. Propojit čínské věci s elektrickým přístrojem, kde je vysoké napětí pomocí PC je více než odvážné. Mělo by to být zcela jistě mnohem lépe galvanicky odděleno, pokud měří člověka s vodivým spojením s jeho prstem. Pokud to mají takhle schváleno, tedy jako celistvý systém měření a následné terapie, je to v pořádku, ale pokud ne, je to velmi závažné.

Zdířky určené pro vysoké napětí pro lampu na Sanoplasmě jsou zcela nevyhovující. Nevíme, jak tohle mohlo projít zkušebnou.

Firma Rifetech: „Působení na lidskou buňku je dále eliminováno speciálními filtry, které omezují vyšší harmonické frekvence.“

Naše zjištění: Filtry tam možná nějaké mají, ale frekvence v řádu MHz z toho přístroje normálně jdou.

Intenzita elmag. pole – naším měřením jsme zjistili něco kolem 90 V/m – ale byl to jen výpočet.

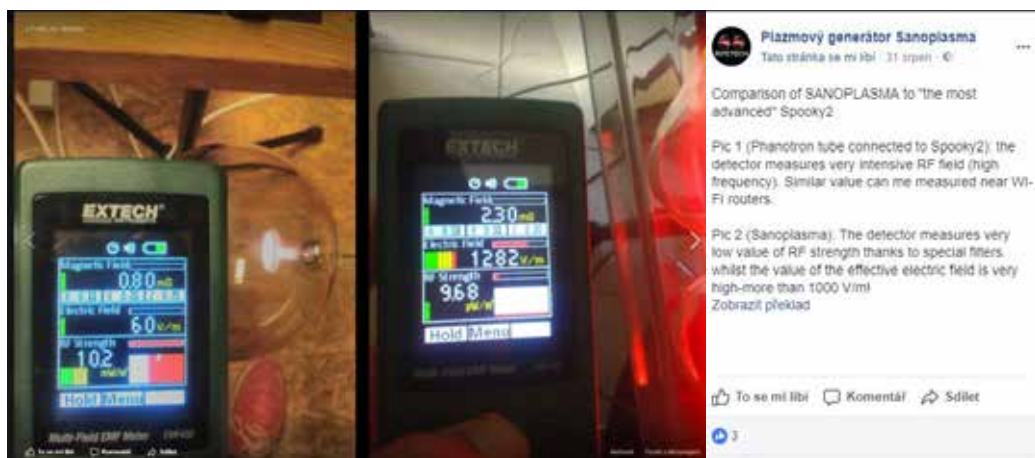

Zde vidíte obrázek, kterým firma Rifetech na svém FB dokazuje, že intenzita elektrického pole je dostatečně silná (1282 V/m), takže není potřebná tzv. nosná frekvence. Totéž tvrdí o síle el. pole přístroje Sanoplasma na svém webu. Je to úsměvné, ale obchodně vynalézavé.

Pole je obecně elektromagnetické. V rozsahu 0–30 MHz převládá magnetická složka, nad 30 MHz převládá elektrická složka. Pokud jde o popis pole, je to tedy nepřesné. Měřit jen elektrickou složku ale lze. Samostatná el. složka ale nic neříká o účinnosti nebo neúčinnosti přístroje. Raymond Rife používal ale co? RF – tedy Radiofrekvenci. Speciálně upravený RF signál. RF je u Sanoplasmy velmi nízká.

Zakoupili jsme tedy stejný přístroj (Extech), kterým tuto hodnotu Rifetech s.r.o. u Sanoplasmy prezentuje, a nestačili jsme se divit. Podívejte se, jak dopadla naše měření:



Měřené hodnoty u trubice velmi kolísají. V tomto místě, jak vidíte na obrázku, je el. pole nejsilnější – alespoň podle tohoto měřicího přístroje (1702 V/m).



Když však stejný přístroj posunete o 10 cm dál od trubice, je to najednou jen 84 V/m.



A když je to 20 cm, tak už je na měřicím přístroji jen 42 V/m.



Ale i v těsné blízkosti trubice Sanoplasmy lze měřit stejným přístrojem zcela jiné hodnoty, například 171 V/m zde. Takže, co udělala firma Rifetech? Nastavila a vyfotila tento měřicí přístroj tak, aby to vyhovovalo tomu, co mělo následovat? A co následovalo?

„Sanoplasma generuje dostatečně intenzivní pole, které samo o sobě zajišťuje penetraci i bez použití potenciálně nebezpečných nosných frekvencí.“ 1 000 V/m!

Představa, že někdo přiloží měřicí přístroj pouze k jedinému místu trubice a tím měření skončí, je legrační. To uvádíme proto, kdyby firma Rifetech začala nyní tvrdit, že tato fakta neznala a že měřili jen u jednoho místa plazmové trubice. To žádný člověk, který má určité zkušenosti s měřením, neudělá.

Celé se to zdálo divné a jediný závěr, který mohl být relevantní a platný, bylo přístroj nechat změřit v certifikované laboratoři, kde bude výsledek jasný. Když firma Rifetech prezentuje uvedené hodnoty, je nutno se na věc podívat certifikovanými měřicími přístroji a schválenými postupy státní zkušební laboratoře.

Přístroj Sanoplasma jsme tedy odvezli do EZÚ – Elektrotechnického zkušebního ústavu, s.p., a zadali měření intenzity elmag. pole přímo u trubice. Výsledek? **Intenzita elektromagnetického pole přímo u trubice přístroje Sanoplasma – max. 98 V/m.**

EZU certifikáty o měření Sanoplasmy.

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, s.p.
Pod Lisem 129
171 02 Praha 8 - Troja

Počet stran: 1
Počet příloh/Počet stran příloh: 0/0

Číslo protokolu: 704185-01/01 Datum vydání: 7. 11. 2017



PROTOKOL O ZKOUŠCE

Výrobek: Plazmový generátor
Typ: Sanoplasma
Jmenovité hodnoty: 230 V
Výrobní číslo: -
Výrobce: Rifetech, s.r.o.
Výrobní místo: neudáno
Objednavatel: Z - technology s.r.o., Severovýchodní II 1455/43, 141 00 Praha 4 - Záběhlice, Česká republika

Počet zkoušených vzorků: 1 ks
Vzorky předloženy dne: 2.11.2017
Místo provedení zkoušek: EZÚ
Zkoušky prováděny v době od 2.11.2017 do 2.11.2017
Jiné údaje: -
Zkušební předpis: Měření intenzity elektromagnetického pole

Zpracoval: Pavel Zabloužil
Schválil: Miroslav Vondra
technický vedoucí zkušební laboratoře



Výsledky zkoušek uvedené v protokolu o zkoušce se týkají pouze zkoušeného předmětu, a pokud není v protokolu o zkoušce uvedeno jinak, byly zkoušky prováděny způsobem a za podmínek stanovených zkoušebním předpisem, technickou normou, návodem a užití a informacemi poskytovatelným výrobcem ke zkoušenému předmětu a za použití výrobkem předepsaného přístroje.

Tel.: 266 104 111

Fax: 266 680 070

www.ezu.cz


Protokol č. - Test report No.: 704185-01/01

Měření elektromagnetického pole

Název výrobku: Plazmový generátor
Typ: Sanoplasma

Jmenovité napětí - Supply voltage: 230V
Frekvence - Frequency: 50Hz
Teplota: 22°C, Rel. vlhkost: 55%

Obr. 1 - Fig. 1: Zkušební uspořádání:



Metoda: Byla použita sonda na měření vysokofrekvenčního elektromagnetického pole používaná při zkouškách podle EN 61000-4-3. Kmitočtový rozsah 0,1 MHz - 18 GHz, rozsah měření intenzity 0,1 - 500 V/m. Na budícím generátoru bylo nastaveno maximální napětí a byly měněny frekvence v rozsahu dle návodu a tvar signálu. Takto bylo nalezeno maximum, při kterém byla nalezena poloha sondy s maximálními údaji. Naměřené maximum bylo zaznamenáno.
Použitý přístroj: Isotropic field monitor PMM-EP603, kalibrace platná do: leden 2019.
Měřicí vzdálenost: 0 cm (v těsném dotyku sondy s výbojkou).
Umístění sondy: oskenován celý povrch výbojky.

Naměřené hodnoty: 98 V/m maximum.



Fotografie měřícího zařízení.

Měřil: Vondra

Datum: 2.11.2017,


Místo měření: EZÚ

Závěry z výše uvedených zjištěných skutečností, si udělejte sami.

Ještě jedna poznámka. Na facebookovém profilu „Sanoplasma“ oznámil „kdoš“ 27. září 2017 nový web - www.plazma-zapper.cz (vlastníkem domény plazma-zapper.cz je dle www.nic.cz od 11. 7. 2017 Lukáš Rymeš), kde byl přímý proklík na videa - na kanál youtube s názvem Sanoplasma. Co myslíte, že tam bylo? Byly na něm **ukradené filmy**. Jeden o životě a díle R. Raymonda Rifa - jehož copyright vlastní Z-Technology s.r.o. (z filmu byl „kýmisi“ odstraněn úvod, kde je jasně uvedeno, že autorská práva tohoto filmu pro ČR a SR jsou ve vlastnictví Z-Technology s.r.o., a tento film byl i přílohou na DVD časopisu Nová Regena). Za práva na film jsme autorovi zaplatili poměrně velké peníze, nechali ho za další peníze otitulkovat... no a „někdo“ si ho takhle zvláštěně přisvojil. Druhý film byl o ničení živých nádorových buněk Anthonyho Hollanda, do něhož jsme umístili české titulky. Právník firmy Rifetech s.r.o. nám ale sdělil, že účet na youtube není firmy Rifetech ©... takže vlastně nevíme, komu patří. Nebýt na něj přímý proklík z webu www.plazma-zapper.cz, neměli bychom v rukou opět nic - ale podle českého práva vlastně ani nyní nemáme, takže - a proto to zde uvádíme - pokud tedy někdo z čtenářů tuší nebo ví, komu účet s názvem Sanoplasma na youtube patří, uvítáme jakoukoliv informaci.

Úsměvně, že? Youtube na naší informaci o porušování autorských práv tento účet zruší.

Na tomto webu www.plazma-zapper.cz je také uvedeno, že „Sanoplasma 2v1 Vyrobeno v ČR“ (viz foto). Takže podle všeho se čínský Spooky generátor a čínský pulzní klip vyrábí v ČR. Kdo že to „manipuluje laickou veřejnost“?



Závěr? Pokud někdo začne bezdůvodně válku, měl by být tři-krát silnější než ten, na koho útočí. V případě firmy Rifetech, která ať už vědomě nebo nevědomě svým zákazníkům nesdíljuje pravdu a deklaruje prapodivné hodnoty svého přístroje, včetně nesmyslného účelu používání, je jasná ukázka nezkušenosti a nezalosti dané problematiky, která může znamenat mnoho problémů pro jakéhokoliv terapeuta. Pokud nám to světlí, tak přeče máme stejnou „plazmu“ jako ostatní... nebo raději... lepší! Tak to ale opravdu není.

Домой

- Info
- SLUŽBY
- FREKVENČNÍ GENERÁTORY
 - PULSNÍ SCAN
 - SANOPLASMA
- E-shop
- Kontakt
- Ceník

Vyhledávání


Hledat

Kontakt

RNDr. Dagmar Jančová, Ph.D.

Naturo–rezonanční poradna
Zámečnická 2 (OD Koruna, 2.
patro)
77900 Olomouc
+420 778 727 810

dagmar.jancova@seznam.cz



Pulsní systém detekce anomálních frekvencí je světovým unikátem!

Cena za komplet Pulsní scanner a zapper 19000 Kč včetně DPH

Bližší informace a předvedení přístroje na tel: +420 778 727 810

PULSNÍ SCAN

CÍLENÁ LIKVIDACE PATOGENŮ

Systém Puls–scan kombinuje frekvenční generátor (zapper) a biofeedback, český návod je součástí balení

Slouží k detekci anomálních frekvencí, které korespondují s viry, bakteriemi a parazity.

Měření je automatické, po zadání počáteční a koncové frekvence (frekvenční pásmo, které chcete skenovat) a upřesnění posunu umístíte klip na ušní boltcec nebo ukazováček. Nyní uchopíte elektrody, zavřete oči a relaxujte. Scan automaticky uloží tzv. hity (frekvence vyvolávající odezvu). Po skončení měření se generátor vrátí k hitům, které přeměří s jemnějším posunem a nejsilnější odezvy se uloží do paměti. Výsledkem jsou tedy přesné frekvence, které můžete ihned aplikovat. Měření je tedy plně automatické a **bezkonkurenčně přesné (měří s přesností na několik desetinných míst)**. Zapperovat lze hned dvě osoby najednou. Díky možnosti nalepovacích elektrod máte volně ruce a lokálně zvýrazníte působení dané frekvence.

mi tento génus 20. století působil na mikroorganismy. Ono to nyní vypadá pro mnoho neznalých lidí možná jednoduše – patogen má frekvenci a pokud tuto frekvenci vyšleme proti patogenu, zničíme ho. To je vysvětlení pro širokou veřejnost a opravdu podobným způsobem přístroje dr. Rifa pracovaly. Pokud ale nemáte přístroj, který generuje vysoce specifické a účinné pulsy, nemáte téměř nic.

Když jsme tento fakt o přání dr. Rifa zjistili, upustili jsme v roce 2015 od úmyslu založit firmu Rife Technology, která by se specializovala pouze na plazmové generátory Athon 7. Nyní je totiž každý přístroj produkující „frekvence“, ten „pravý Rife“. Je to jak v zoo...

Team
Z-Technology s.r.o.

... a ještě jedna malá poznámka – když půjdete na webové stránky www.rife-generator.cz, najdete tam samozřejmě nabídku na Sanoplasmu. Ale také na „pulsní scanner a zapper“, což je samozřejmě také „Světový unikát“, jak je zde uváděno – za 19 000 Kč. Je to totiž právě onen „Funkční“ generátor DUCH za 115 USD a snímač srdečního tepu DUCH za 58 USD. Tedy dohromady za cenu 173 USD, což je **3 840 Kč** (kurz 22,20 Kč/USD). Vy si však tento světový unikát můžete zakoupit za pouhých **19 000 Kč**. Tomu se říká výdělek. ©

Bylo nám to divné, toto opravdu není standardní, a tak jsme poslali na uvedený kontakt dotaz, zda je to cena včetně notebooku, který je na obrázku.

Přišla takováto odpověď:



Dobrý den,! Děkuji za Váš zájem. Cena pulsního scanu je za zapper-scanner s příslušenstvím (elektrody, měřič pulsu), školení. Jakýkoliv počítač nebo notebook musí mít každý svůj vlastní. Většina lidí si bere rozšířenou variantu s lepicími elektrodami (dva další dlouhé kábly, deset párů lepicích elektrod), která vyjde se vším všudy na 20.500,- žádné další náklady s tím spojené nejsou, až po řadě měsíců, když byste intenzivně používal ty lepicí elektrody, tak se koupí deset párů nových koncovek 300,- Kč. Pokud byste si chtěl přístroj prohlédnout a vyzkoušet, mám ho samozřejmě v Olomouci, taktéž tu můžete vyzkoušet Sano-plasmu, kterou tu už teď používáme jako výhradní typ plazmového generátoru. Zavolejte kdykoliv. 778 727 810

Srdečně zdraví Dagmar Jančová

Závěry si udělejte opět sami...

Dr. Royal Raymond Rife si vysloveně nepřál, aby jeho jméno bylo v budoucnosti spojováno s jakoukoli firmou. Zřejmě předpokládal, co by se mohlo stát a co se také bohužel stalo. Dnes se jakýkoliv výrobce „plazmy“ či frekvenčních generátorů odvolává na výzkumy dr. Rifa, a to i tehdy, pokud nemá téměř žádné relevantní informace o jeho práci a principech přístrojů, který-

ZDÁ SE, ŽE NĚCO NENÍ SPRÁVNĚ. JE TO JAKO V ZOO.

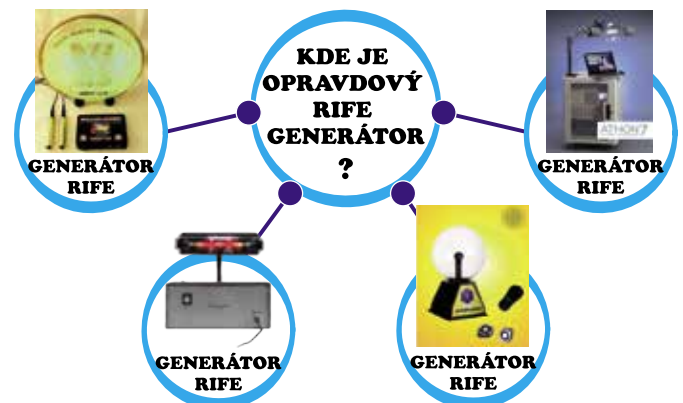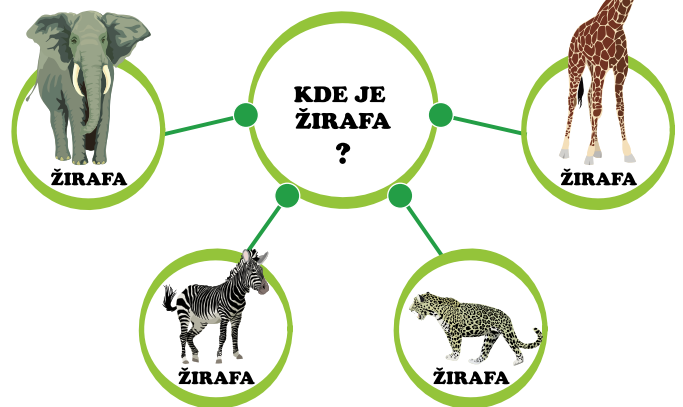

TEĎ UŽ TO VÍTE.

19. 11. 2017 – těsně před odesláním tohoto čísla NR do tisku přišel od firmy Rifetech mail mému kamarádovi, který si Sanoplasmu zakoupil a po našich zjištěních z měření, které jsem mu sdělil, ji v zákonné lhůtě 14 dní firmě Rifetech s.r.o. vrátil.

13 dní po převzetí balíku se Sanoplasmou nebyla ze strany Rifetech s.r.o zcela žádná reakce, a tak poslal firmě textovou zprávu, že pokud nebudou do druhého dne peníze na jeho účtu, předá vše ČOI. Byla to informační sms. Za hodinu peníze na účet někdo vložil. Poté přišel tento mail:

Dobrý den, pane ...,
v příloze vám posíláme opravný daňový doklad na základě Vašeho odstoupení od smlouvy. Vrácenou platbu máte na svém účtu v zákonem stanovené lhůtě 14 dnů, vaše výhrušná SMS ohledně kontroly z ČOI nebyla opodstatněná. Vyřídte vašemu kamarádovi Pavlovi, že pokud k nám dorazí jediná kontrola, k němu dorazí kontroly ze všech úřadů.

Přeji pěkný večer, s pozdravem
Rymešová Rifetech s.r.o.

Osobně se držím hesla *Nedělej to, co nechceš, aby ti dělali jiní.*

Takže pokud k firmě Rifetech dorazí jakákoliv kontrola, „impuls“ nepřijde rozhodně od nás. My jsme kontrol na udání v minulosti absolvovali již opravdu hodně a jsme z nich výrazně poučení.

Vzhledem k tomu, co má firma Rifetech ve svých veřejně dostupných prezentacích, se její kontrole ze strany dozorových státních orgánů ale divit vůbec nebudeme. Nyní pro mne v podstatě vše, co tuto firmu charakterizuje, je celistvá neznalost problematiky a vyhrožování. Moc pěkné...

Pavel Eiselt
Z-Technology s.r.o.